

México, 6 de marzo de 2023

Ing. Fanny Alvarado Chávez  
Instituto Nacional De Ciencias Médicas Salvador Zubirán

# Cotización

Estimado Cliente:

Es un placer para *Baxter S.A de C.V* someter a su consideración la siguiente Propuesta de Servicio para Máquinas de Terapia aguda modelo *PRISMAX*.


Código	Descripción	Periodo Contractual	Precio Anual
TSICCM	Póliza PRISMAX Care Total – SN 106964	1 abril 2023 – 31 marzo 2024	\$99,303.75
		1 abril 2024 – 31 marzo 2025	\$99,303.75
		1 abril 2025 – 31 marzo 2026	\$99,303.75
		<b>TOTAL (MXN)</b>	<b>\$297,911.25</b>

Condiciones:

- *Mano de Obra y Refacciones* para la realización de un (1) Mantenimiento Preventivo en las facilidades del cliente, el cual se llevará a cabo a más tardar el *30 de septiembre* de cada periodo contractual.
- *Mano de Obra y Refacciones* para todas las reparaciones derivadas de un *uso y desgaste normal* del equipo. Baxter hará todos los acomodos razonables para que el Ingeniero que atienda la llamada de servicio lleve consigo las refacciones requeridas de forma tal que la reparación quede completada en la primera visita, sin embargo, de no contar con la refacción en Mexico el tiempo de espera máximo para la importación sera de 90 días.
- *Mano de Obra y Refacciones* para un máximo de 2 eventos relacionados con Daño Colateral incluyendo, pero no limitado a: *Perdida de accesorios de la máquina, roturas o daños ocasionadas por un mal manejo del equipo, uso del equipo fuera de las condiciones establecidas en el manual del operador concerniente a condiciones ambientales, eléctricas, infraestructura, insumos no aprobados, entre otras.*
- La mano de obra, refacciones y gastos de viaje para *eventos adicionales* relacionados con Daño Colateral serán *cotizados por separado*.
- Tiempo de respuesta en Mantenimientos Correctivos será de 24 horas hábiles (lunes a viernes) después de haber recibido el reporte a través de nuestro *centro de atención telefónica* el cual opera las 24 horas del día y los 7 días de la semana.
- Periodo de cobertura: 1 de abril de 2023 al 31 de marzo de 2026

RRP

l

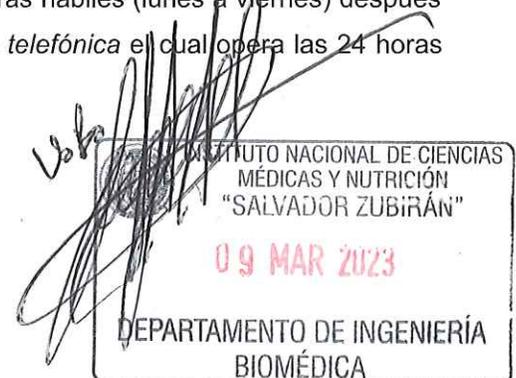

- El Precio Anual será facturado de la siguiente forma:
  - o 1er año
    - 50% - septiembre 2023
    - 50% - marzo 2024
  - o 2do año
    - 50% - septiembre 2024
    - 50% - marzo 2025
  - o 3er año
    - 50% - septiembre 2025
    - 50% - marzo 2026
- Precio NO incluye IVA
- Cotización valida hasta el 30 de marzo de 2023
- Anexo 1 - Rutina Mantenimiento Preventivo

rep

Le agradezco la atención prestada a la presente y quedo a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración.

Cordialmente,



Jose M. Hernández  
Global Services Manager  
Mexico, Central America, Puerto Rico and Caribbean  
[jose\\_m\\_hernandez@baxter.com](mailto:jose_m_hernandez@baxter.com)

Erandy Yanahí Federico Reyes  
Representante legal de BAXTER



**ANEXO 1  
RUTINA MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

El mantenimiento preventivo para los equipos de terapia renal aguda Prismax comprende lo siguiente:

1. Limpieza del equipo: incluye eliminar polvo, desechos y/o líquidos secos en las superficies externas e internas.
2. Cambio de componentes incluidos en el kit de mantenimiento:
  - a. Conos de sellado de cápsulas de presión (3 piezas)
  - b. Amortiguadores de rotor de bomba de sangre (2 piezas)
  - c. Amortiguadores de rotor de bomba de fluido (10 piezas)
  - d. Segmento de filtros y bombas ARPS (1 pieza)
3. Calibración y/o verificación de:
  - a. Cumplimiento de ARPS
  - b. Detección de retorno
  - c. Lector de código de barras
  - d. Audio
  - e. Sensores de presión
  - f. Básculas
  - g. Placa de aislamiento
  - h. Detector de burbujas de aire
  - i. Pinza de retorno
  - j. Detector de fugas de líquido
  - k. Descargador
  - l. Bomba de jeringa
  - m. Detector de fugas de sangre
4. Inspección de seguridad eléctricas.
  - a. Prueba de tierra protectora
  - b. Prueba de corriente de fuga a tierra
  - c. Prueba de corriente de fuga del paciente
5. Prueba funcional: simulación de terapia

RRP

l

